Sundhedsstyrelsen
Statens Institut for Strålehygiejne

Navn CPR. nr.

Adresse

Højde Vægt

Rum nr.

Graviditets uge

Henvisende læge

Nr	kV	mAs	mA	s	Snittykkelse (mm)	Pitchfaktor	CTDI (mGy)	Spiral	Antal snit
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

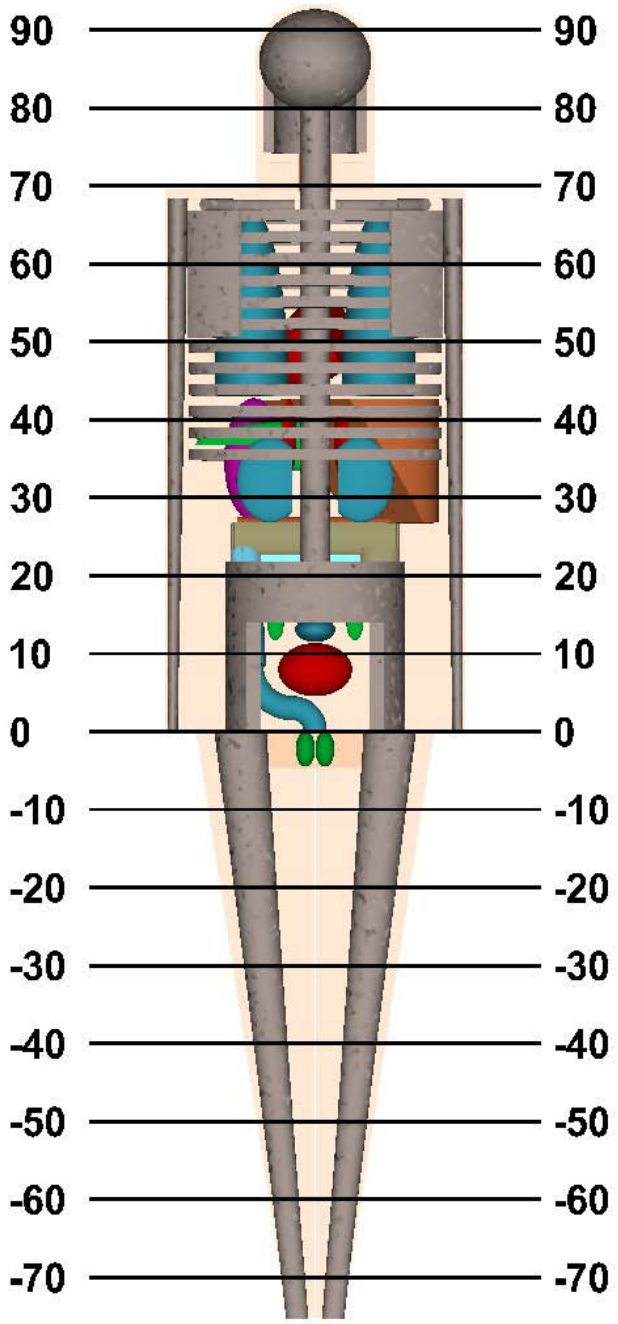
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70

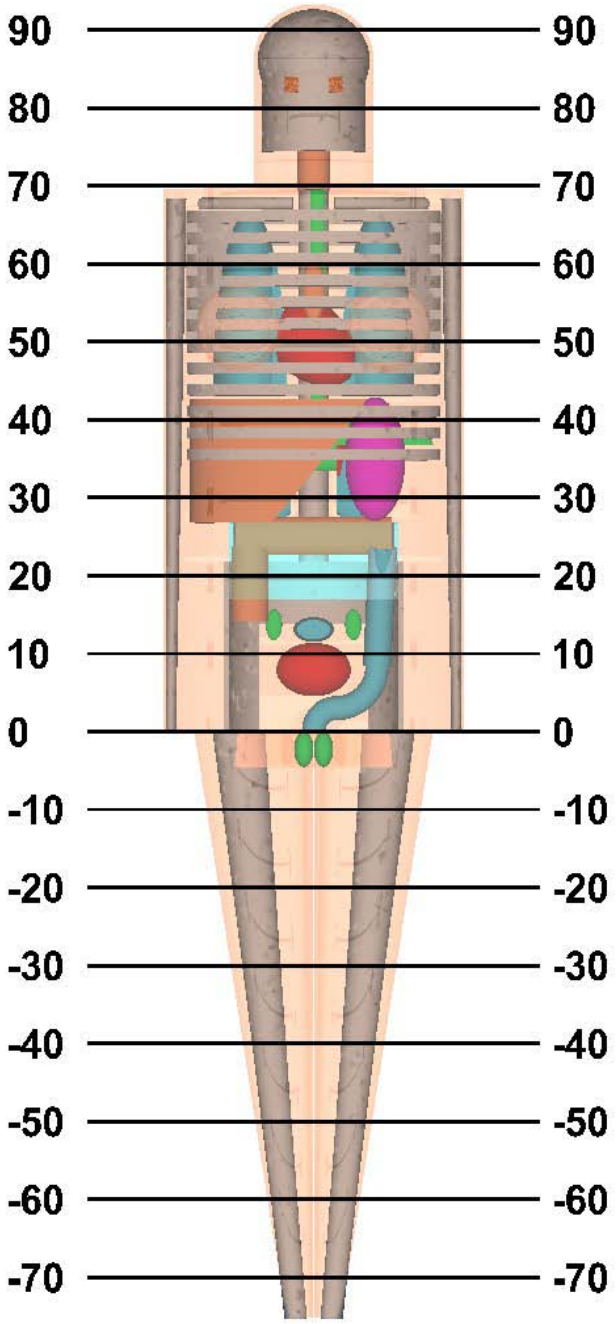
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70